



مُسْتَشْفَى الْجَامِعَةِ الْأُرْدُنِيَّةِ

JORDAN UNIVERSITY HOSPITAL

دائرة العطاءات والتزويد
Tenders and Supply Department

م ج ا ل / 3 / 2025
الرقم
29 / 5 / 2025

قرار إحالة رقم: (97/0029/2025) لجنة الشراءات الفرعية
رقم طلب الشراء: (224000726) رقم الحجز: (224000743)
الرقم المتسلسل: (224000726)

موضوع الشراء: () توريد وتركيب وتشغيل وصيانة جهاز High Performance liquid Chromatography /
() القيمة الإجمالية للشراء: () 33000 حاجة مختبر السموم
ثلاثة وثلاثون ألفا ديناراً لا غير

العروض الواردة

- 1- مؤسسة دنيس لتجارة الاجهزة المخبرية
- 2- شركة بونسيانا للانظمة العلمية
- 3- شركة التحليل الواحد للتجارة

وإستناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (66) من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
فقد قامت اللجنة بتفريغ ودراسة العروض دراسة تفصيلية، وبناءً على التوصية المقدمة من اللجنة فقد تقرر ما يلي

إحالة المادة التالية على السادة / شركة بونسيانا للانظمة العلمية، و كما يلي:-

بند	المادة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الضريبة	الخصم	المجموع
1	توريد وتركيب وتشغيل جهاز high Performance Liquid Chromatography HPLC Model: AZURA HPLC System DAD Detector حسب المواصفات المرفقة	eac	1	33000.0			33000

قيمة الإحالة :- 33000.000 | ثلاثة وثلاثون ألفا ديناراً لا غير
الأسعار :- شاملة كافة الرسوم الجمركية ورسوم الإستيراد وأية رسوم وضرائب أخرى واصل مستودعات مستشفى الجامعة .

أسباب الإحالة	المنشأ	الشركة الصانعة
(1)	Germany	KNAUER

بند	المدة	الكمية
بند (1)	2-6 اشهر	1



مُسْتَشْفَى الْجَامِعَةِ الْأُرْدُنِيَّةِ

JORDAN UNIVERSITY HOSPITAL

دائرة العطاءات والتزويد
Tenders and Supply Department

م ج ا ل / 3 / 2025

الرقم:

التاريخ: 2025 /

الشروط :-

- 1- تسليم المواد المطلوبة خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك .
- 2- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة (10%) من قيمة المواد المحالة عليه .
- 3- مع مراعاة ما ورد في المادة 89 من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 اذا تاخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به عن الموعد المحدد بالعقد يفرض غرامات تاخير على النحو التالي ما لم يرد خلاف ذلك في وثائق الشراء :
- ما نسبته (0.001) واحد بالالف من قيمة اللوازم عن كل يوم تاخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن الفترة من (1) يوم - (45) يوم.
- ما نسبته (0.002) اثنان بالالف من قيمة اللوازم عن كل يوم تاخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن الفترة من (46) يوم - (60) يوماً .
- ما نسبته (0.003) ثلاثة بالالف من قيمة اللوازم عن كل يوم تاخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن كل يوم تاخير يزيد عن (60) يوماً .
- 4- يلتزم المتعهد التزاماً تاماً بما ورد في قرار الإحالة من حيث الأسعار و الكميات و المواصفات و ماورد في العرض ومدة التسليم و الشروط العامة.
- 5- يلتزم المتعهد بدفع رسوم الإحالة والطوابع خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه لقرار الإحالة .
- 6- تعتبر الأسعار الإفرادية في عروض الشركات المحال عليها هذا القرار هي الأساس في حالة وجود اختلاف بينها وبين الاسعار الافرادية في قرار الإحالة .
- 7- في حالة مخالفة المتعهد لما ورد في قرار الإحالة يطبق عليه نصوص المواد الواردة في نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022) وتعليماته .
- 8- يتم التوريد بالإتفاق مع أمين المستودع هاتف (2106)

الشروط الخاصة:-

- 1- التزام بتقديم كفالة صيانة بنسبة 5% لمدة عامين شاملة قطع الغيار والايدي العاملة وغير شامل المستهلكات
- 2- الالتزام بقائمة المستهلكات لمدة 5 سنوات وبتوريدها بسعر تفضيلي 15% لاول سنتان
- 3- الالتزام بقائمة اسعار قطع الغيار لمدة 5 سنوات بعد انتهاء الكفالة المجانية
- 4- الالتزام بكفالة البرامج وتحديثها بالنسخ الحديثة مجاناً لمدة 5 سنوات
- 5- الالتزام بتقديم عقد صيانة بقيمة 8% من قيمة الجهاز بعد انتهاء فترة الكفالة
- 6- الالتزام بالتدريب الداخلي لشخصين على الاقل لتغطية :
Operation training***
Application training ***
7- الالتزام بتقديم مايلي :
PC i3 Ram 8 Lenovo or Dell with 24 LED** عدد (1) مجاناً
Vials Boxes** عدد (50) مجاناً
Filter Syringe** عدد (10) مجاناً
8- أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء

رئيس لجنة الشراءات الفرعية

د. باسم حنا
781512025

أمين سر اللجنة

ولاء عوقل

عضو

رشا خريسات

عضو

امين قاسم

مندوب ديوان المحاسبة

منال الحارثي
٢٠٢٥/٥/٢٨

مصادقة القرار

استناداً للمادة (66/ج) من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية /الامين العام

الاستاذ الدكتور خالد محمد البصول

٢٧/٥/٢٠٢٥



الموضوع : قائمة قطع الغيار لطلب شراء رقم 224000726

السادة : مستشفى الجامعة الأردنية المحترمين
السادة : دائرة العطاءات والتزويد المحترمين

تحية طيبة وبعد :

ردا على كتابكم بشأن تقديم قائمة قطع الغيار:

UV PCB Board	2,500.00	JD
UV Cell	1,200.00	JD
UV Power Supply	750.00	JD
Pump PCB Board	2,200.00	JD
Pump Mator	550.00	JD
Pump Pauer Supply	750.00	JD
Pump Head Assy	2,400.00	JD
Auto Sampler PCB Board	2,700.00	JD
Auto Sampler XYZ Assy	2,150.00	JD



Poinciana for Scientific Systems
بونسيانا للأنظمة العلمية

Auto Sampler Power Supply	750.00	JD
Auto Sampler Cooler Assy	3,200.00	JD
Oven PCB	1,250.00	JD
Oven Power Supply	700.00	JD

والأسعار غير شاملة لضريبة المبيعات .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.



شركة بونسيانا للأنظمة العلمية

تلفون : 06-5711177

فاكس : 06-5711178

Part Name	Qty	سعر القطعة الواحد
Mobile Phase filter	1	85.0
Plunger Seal	1	90.0
Plunger O-Ring	1	55.0
Pump Filter	1	95.0
Check IN valve	1	175.0
Check Out Valve	1	175.0
Sample Needle Assy with fitting & Tube	1	425.0
AutoSampler Rotor	1	375.0
Deuterium Lamp	1	950.0
Vials	1	25.0
HPLC Column	1	325.0
W-Lamp	1	225.0
Plunger Assy	1	375.0
Autosampler Syringe	1	450.0
Flow Cell Window + Ring	1	255.0
Needle Seal	1	275.0
AutoSampler Stator	1	475.0
AutoSampler Syringe Rotor	1	475.0
Ferrels high Pressure 10/Box	1	95.0
Sample Loop	1	290.0

- الأسعار بالدينار الأردني غير شامل الضريبة العامة عالمبيعات وشامل الشحن والجمرك.
- الأسعار ثمن القطعة الواحد وقد يتطلب أن يتم تبديل أكثر من قطعة خلال العام لبعض القطع وقد يحتاج تبديل بعض المستهلكات كل عامين أو أكثر " حسب الاستخدام ".
- القائمة أعلاه تتضمن جميع المستهلكات ونتعهد بهذه الأسعار طيلة فترة الضمان وتشمل التركيب والصيانة مجاناً.



مستشفى الجامعة الأردنية
دائرة العطاءات والتزويد



Made in Germany

BRAND

طلب شراء رقم : 224000726

Poinciana for Scientific Systems

شركة بونسيانا للأنظمة العلمية


OFFER

Date	02.03.2025
Ref. Number	
CUSTOMER NAME	



مستشفى الجامعة الأردنية

No.	P/N	DESCRIPTION	QTY.	UNIT PRICE	DISCOUNT	TOTAL PRICE
1	986 502 200	AZURA HPLC System " DAD-Detector ", includes:	1			
	AZC00	Eluent Tray E 2.1L	1			
	A5324-3	4 bottles 1000 ml for solvents and 1 bottle 250 ml for backpiston flushing. GL45	1			
	APH34EA	P 6.1L Pump P 6.1L (LPG) with 10 ml pump head (stainless steel), degasser: *Flow rate range 0.001 - 10 ml/min *Maximum delivery pressure 862 bar, 12,500 psi, 86 Mpa *Pump head materials Stainless steel *Gradient Low pressure gradient (quaternary) *Gradient range 0 - 100% *Flow rate accuracy < 1 % *Flow rate precision ≤ 0.1 % RSD *Gradient accuracy ± 0.3 % at 1 ml/min, 150 bar ethanol/cafeine tracer) ± 2 % (1 - 99 %, measured at 5 - 50 % of the flow range, water/cafeine tracer) *Gradient precision < 0.1% RSD at 1 ml/min, 0.5% RSD overall, based on retention time at constant room temperature *Mixing volume 200 µl *Active piston seal wash Yes *Piston seal washing Yes *System protection Soft start, Pmin und Pmax are programmable *Leak sensor Available (Standard)	1			
	AAA51AA	AutoSampler 6.1L, 862 bar, with cool/heat 4 to 45C, 100 µl loop *Maximum back pressure 862 bar *Injection volume range 0.1 µl - 10 ml depending on sample loop *Sample loop 100 µl *Dispenser syringe 250 µl *Piercing needle precision ± 0.6 mm *Vial detection missing vial/well plate detection by sensor *programmable: wash between injections and wash between vials *Injection cycle time minimum 7 s from the same vial, 14 s from different vials; < 60 s for >100 µl sample injection in all injection modes, incl. 300 µl needle wash *Sample carryover < 0,01 % under typical conditions using needle wash; < 0.0003 % under special conditions with extended needle wash Injection precision RSD (Relative Standard Deviation):full loop injection: <0.3%partial loop injection at injection volume>5 µl: <0.5%microliter pickup injection at an injection volume>5 µl: <1.0%	1			
	ADC01	DAD 2.1L Diode array detector 190 - 800 nm, with test cell without flow cell *Number of diodes 256 *Pixel pitch 2 nm/diode *Detection channels 8 (Digital)/4 (Analog) *Light source Deuterium (D ²) lamp with integrated GLP chip *Wavelength range 190 - 800 nm *Spectral bandwidth <10 nm at Hα line (FWHM) /Note: digital bandwidth 1 - 32 nm *Wavelength accuracy ± 1 nm *Noise ± 5 µAU at 254 nm (ASTM E 657-98) *Drift 400 µAU/h at 254 nm (ASTM E1657-98) *Linearity > 2.0 AU at 274 nm (ASTM E1657-98)	1			

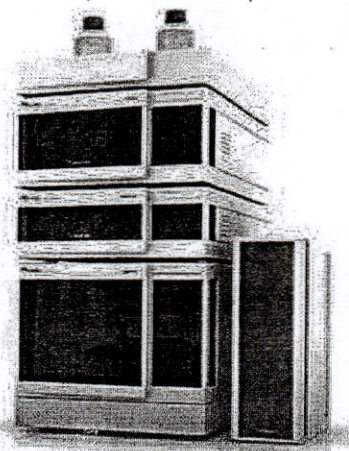

Handwritten signature




	* Maximum data rate 100 Hz (LAN)/12.5 Hz (analog) * Time constants 0.00 / 0.01 / 0.02 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0 s * Wavelength verification Internal holmium filter and deuterium lines			
AMC38	Flow cell cartridge Pressure Proof, Titanium 10mm, 10µl, 1/16", 300 bar for AZURA DAD/MWD	1		
ATC00	Column Oven - Column Thermostat CT 2.1: * Temperature range 5–85 °C * Column Compartment up to 8 columns * Heating/cooling rate 2 °C/min * Temperature accuracy ± 0.2 °C * Temperature stability ± 0.1 °C * Leak sensor gas sensor, adjustable sensitivity, acoustic signal, turn-off switch * self-check and auto-calibration at power-on, selectable turn-off temperature	1		



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



A1670

ClarityChrom 9 - Workstation, autosampler, single instrument license one time base

1

KNAUER ClarityChrom® is a powerful, easy-to-use chromatography software for instrument control, data acquisition and data processing. It is an economical solution compared to other more complex chromatography software while still offering FDA 21 CFR Part 11 compliance.

ClarityChrom comes as a complete package with LC control and including autosampler control. It is scalable from 1 up to 4 systems; depending on the desired instruments. The built-in fractionation option as well as the optional extensions as SST for automated system tests, PDA for 3D (UV spectra) data handling, GPC analysis, MS and GC control cover a wide range of the requirements for a CDS on a modern lab. KNAUER additionally offers more advanced fractionation with the KNAUER FRC control module.

A1676

ClarityChrom 9.0 - PDA 3D Extension

1

The PDA option allows to acquire and process spectra (3D data) from a photo diode array detector. KNAUER PDA detectors are fully supported. The PDA extension provides peak purity analysis and peak identification by spectral library search in self-made or commercial spectra libraries.

IQ/OQ

Qualification Documents - Hard copy - Single copy

1

مستشفى الجامعة الأردنية
دائرة المعطيات والتزويد